

MNCHIP

Celercare V5

Otomatik Biyokimya Cihazı



Ksenon ışık kaynağı



Mikroakışkan
Reaktif Rotor



18 aylık
raf ömrü



Kullanıma hazır reaktifler.
Isınma süresi gerektirmez.

7 DAKİKA

Örnekten cevaba
3 basit adımda ve
yaklaşık 7-10 dakikada


27 TESTLER

Tek seferde 27 test



**Anında Sonuç,
Doğru Karar**

“Kolay taşınabilir kompakt
biyokimya çözümü!”

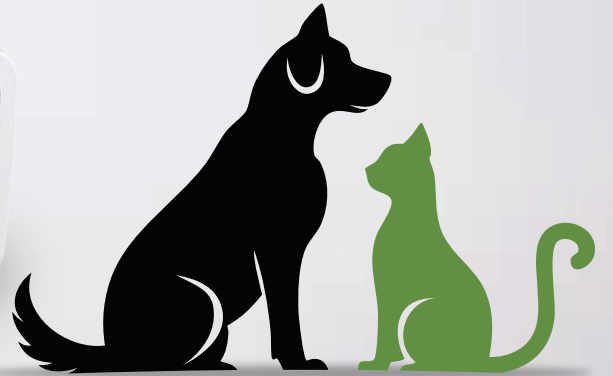

Daha fazlası için;


 **hasvet®**



Otomatik Biyokimya Cihazı

Celercare® V5 Panelleri

Toplam 44 parametreyi kapsayan 21 özel test paneli mevcuttur.

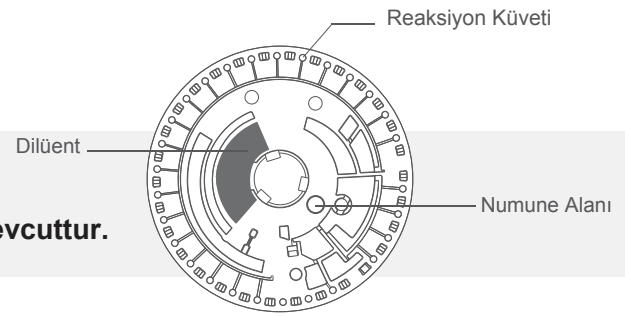[illegible]

* Hesaplanan Parametre #Yakında